

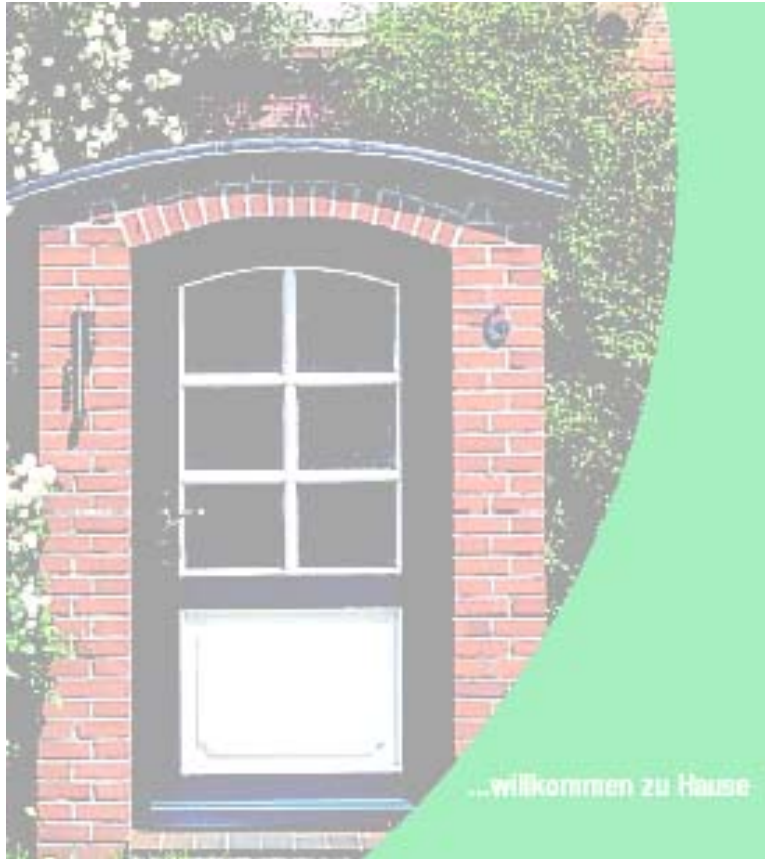


# Heimhämodialyse mit Gambro

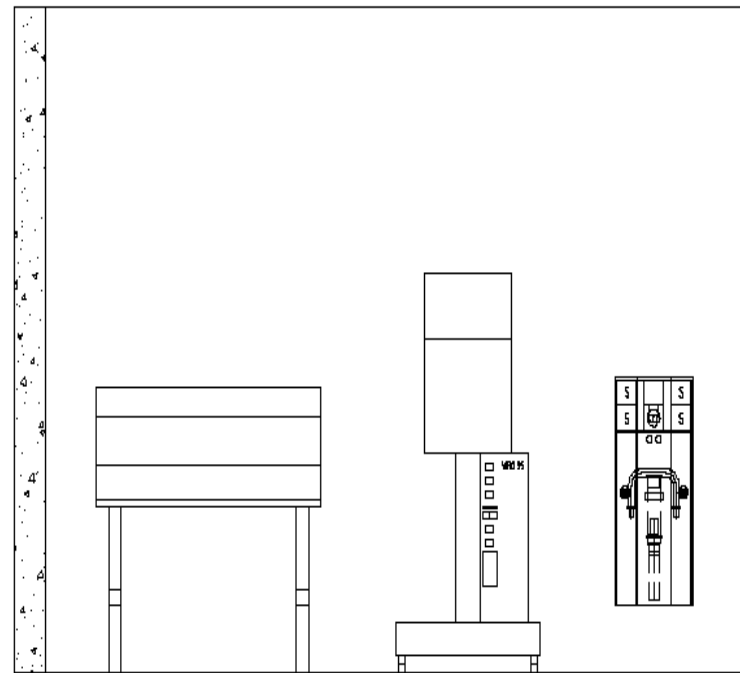

# Die Technik für die Heimdialyse

# Einrichtungsbeispiel

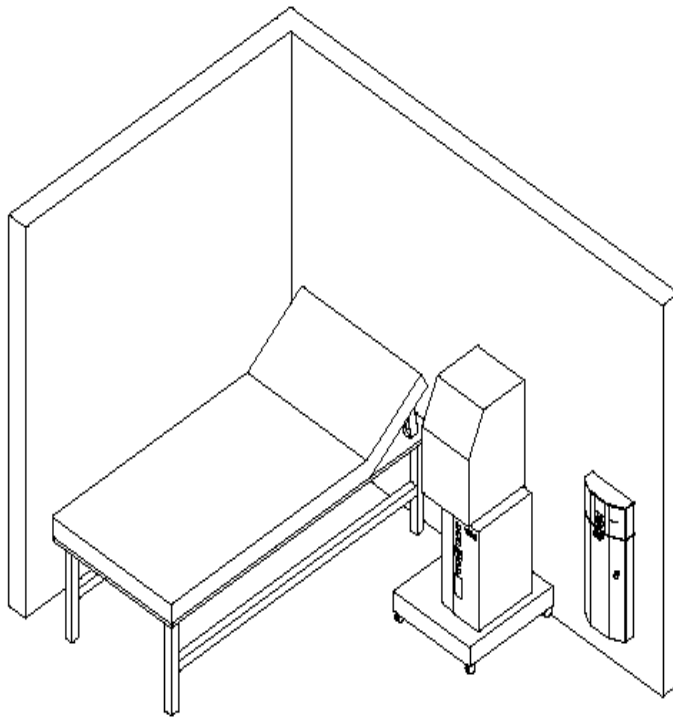

# Das Dialysegerät für die HHD



## AK 95 S

# Das Dialysegerät für die HHD – AK 95 S



- **Ultrareine Dialysierflüssigkeit**
- **High- und Low Flux Filter**
- **Einsatz von BiCart mit Softbag**
- **Sequentielle Dialyse**
- **SN „Klick-Klack“**

# Das Dialysegerät für die HHD – AK 95 S



**Remote Panel**

# Die Osmose für die HHD - WRO 95



- **Permeatleistung bis 1,1 Liter/Min.**
- **Minimale Geräusentwicklung**
- **Remote Start mit dem Dialysegerät**

# Heimhämodialyse mit Gambro

